

1. Иоффе В. И., Рубель Н. Н., Касник Ф. И., Московцева К. И., Тихонова В. И. и Гечевская В. А. ЖМЭИ, 1943, 12.—2. Навроцкий В. К. Вестн. АМН СССР, 1960, 3; 1963, 8.—3. Шубик В. М., Сафьян Б. Э., Шубик Ю. Г. Гиг. и сан., 1959, 9.—4. Фридлянд И. Г. Там же, 1959, 8.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УДК 618.12

ФИКСАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРТУБАЦИИ И ГИДРОТУБАЦИИ


А. И. Мацуев и А. В. Степанова

*Гинекологическое отделение Починковской центральной районной больницы
(главврач — В. С. Тарасов) Смоленской области*


Одним из условий успешного проведения продувания маточных труб и гидротубации является плотное закрытие отверстия шейечного канала, которое исключало бы выход из полости матки воздуха или жидкости.

Внедрение в широкую практику пертубации сопровождалось созданием различных видов наконечников к аппаратам для продувания маточных труб. Так, И. С. Леженченко (1925) применил наконечник от брауновского шприца. На расстоянии 5 см от конца наконечника создавалось утолщение в виде валика, которое способствовало более плотному закрытию просвета шейечного канала.

Мокко (1926) одним из первых применил металлическую трубку с наконечником конической формы. Шейку матки прижимали к конусу двузубцем Мюзо. Этот наконечник с некоторыми изменениями (Темешвари, 1928; М. К. Бутовский, 1929; А. Э. Мандельштам, 1947, и др.) наиболее часто применяется и в настоящее время.

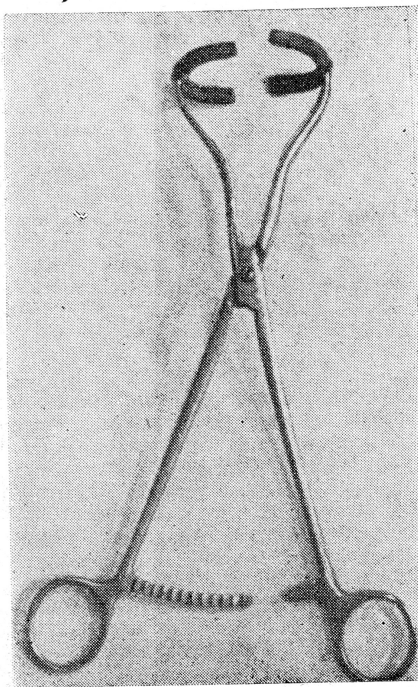

а

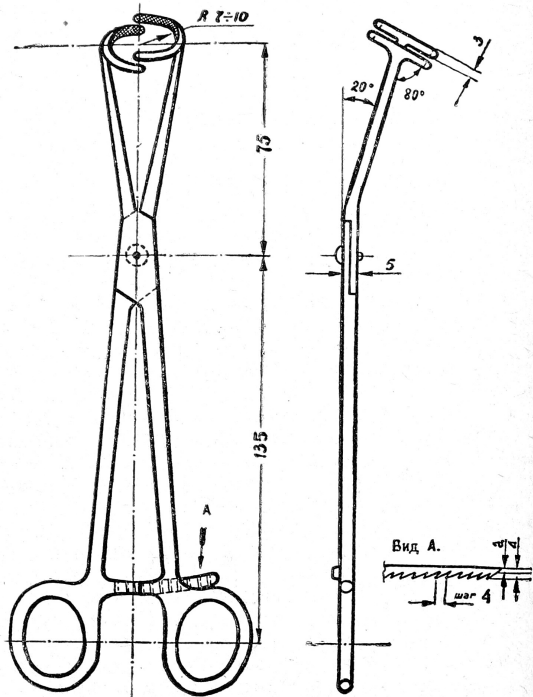

б

Рис. 1. Зажим для шейки матки.
а — общий вид; б — схема.

По мнению некоторых авторов, конусовидное утолщение на наконечнике должно быть подвижным (Иогансон, 1956; Пиэ, 1957, и др.). Зиглер (1959) на поверхности конуса создавал круговые углубления, которые должны были обеспечить плотное его прилегание к слизистой шейки матки.

Наконечник с конусовидным утолщением нашел применение и в гистероманометре Я. И. Русина (1941, 1959).

Существенным недостатком в использовании конусовидного наконечника является необходимость захвата шейки матки двузубцем Мюзо, что сопряжено со значительной травматизацией шейки, особенно заметной при проведении тура гидротубации.

Г. К. Живатов (1929), Рубин (1947) и М. С. Панпулов (1955) в своих «самодержащихся внутриматочных канюлях» использовали по такому же принципу резиновые баллончики, надеваемые на конец металлической трубки. Однако при проведении пертубации резиновый баллончик часто выскальзывает из шеечного канала.

Фикентшер и Семм (1959) предложили наконечник в форме бокала («баллон-катетер»), к которому шейка матки присасывается вакуумным способом. Аппарат имеет сложную конструкцию и пока не получил широкого распространения в клинических условиях.

Все это побуждает к созданию такого наконечника или способа фиксации шейки матки, которые обеспечивали бы надежное закрытие шеечного канала и минимально травмировали шейку матки.

Мы сочли возможным поделиться своим опытом фиксации шейки матки при проведении пертубации и гидротубации. В полость матки нами вводится наконечник от шприца Брауна. Фиксация наконечника в шеечном канале осуществляется изготовленным нами металлическим зажимом (рис. 1, а и б).

Зажим для шейки матки создан на основе большого педана, к клеммам которого приварены два металлических полукруга с радиусом 9 мм. Оба полукруга вогнутыми сторонами обращены друг к другу. При этом одна дуга зажима расположена на 1—2 мм выше другой, что позволяет им при закрытии зажима заходить друг за друга и зажимать шейку матки любого размера. Целесообразно дальний полукруг зажима накладывать на заднюю поверхность шейки.

Созданные на внутренней поверхности полукругов насечки предупреждают соскальзывание зажима с шейки матки. С этой же целью на дуги зажима могут быть надеты резиновые трубочки. Перед наложением зажима шейка матки должна быть очищена от слизи.

Степень зажатия шейки матки регулируется замком в ручке зажима.

Мы предпринимали фиксацию шейки матки описанным зажимом у 30 женщин при проведении гидротубации. Курс лечения состоял из 3 туров по 8—10 гидротубаций каждый. Таким образом, за период лечения шейка фиксировалась 25—30 раз. Никаких осложнений при этом нами не отмечено.

Описанной конструкции зажим может быть изготовлен в любых условиях и в простых мастерских. Он обеспечивает надежную фиксацию и зажатие шейки матки при проведении гидротубации и пертубации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутовский М. К. Журн. акуш. и жен. бол., 1929, 6. — 2. Живатов Г. К. Там же, 1929, 2. — 3. Легенченко И. С. Казанский мед. ж., 1925, 8—9. — 4. Мандельштам А. Э. Функциональная диагностика в гинекологии. Медгиз, Л., 1947. — 5. Панпулов М. С. Акуш. и гин., 1955, 6. — 6. Русин Я. И. Контрастная рентгенография в гинекологии. Медгиз, М., 1959. — 7. Johanson C. E. Ann. Chir. Gynaec. Fenn., 1956, 45, 3, 245—249. — 8. Mosquöt M. P. Bull. mem. Soc. nat. Chir., 1926, 14, 450. — 9. Pye M. A. C. r. Soc. franç. gynéc., 1957, 1, 28—30. — 10. Rubin I. C. Uterotubal insufflation. A clinical diagnostic method of determining the tubal factor in sterility. St. Louis, 1947. — 11. Siegler A. M. Fert. a. Steril., 1959, 10, 1, 29—45. — 12. Temesvary. Arch. Gynäk., 1928. — 13. Fikentscher R. u. Semm K. Geburtsh. u. Frauenheil., 1959, 19, 10, 867—870.

УДК 612.118.221.2

ЗАГОТОВКА АНТИРЕЗУСНОЙ СЫВОРОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГЛЮКИНА

Р. Г. Ганелина

Сывороточная лаборатория Республиканской станции переливания крови (главврач—Л. И. Мухутдинова), Казань

Во избежание осложнений в настоящее время каждому больному перед гемотрансфузией необходимо определять резус-принадлежность, для чего требуется антирезусная сыворотка. До последних лет лечебные учреждения ТАССР испытывали недостаток в антирезусной сыворотке.